




151142340674

江西省贝源检测技术有限公司

检测报告

检测类型：委托检测


报告日期：2023 年 11 月 20 日

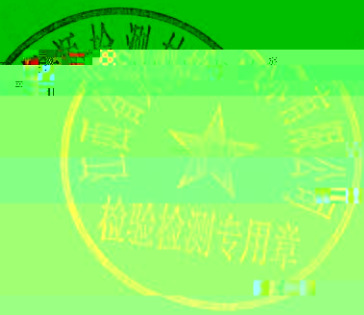




检测



报告声明

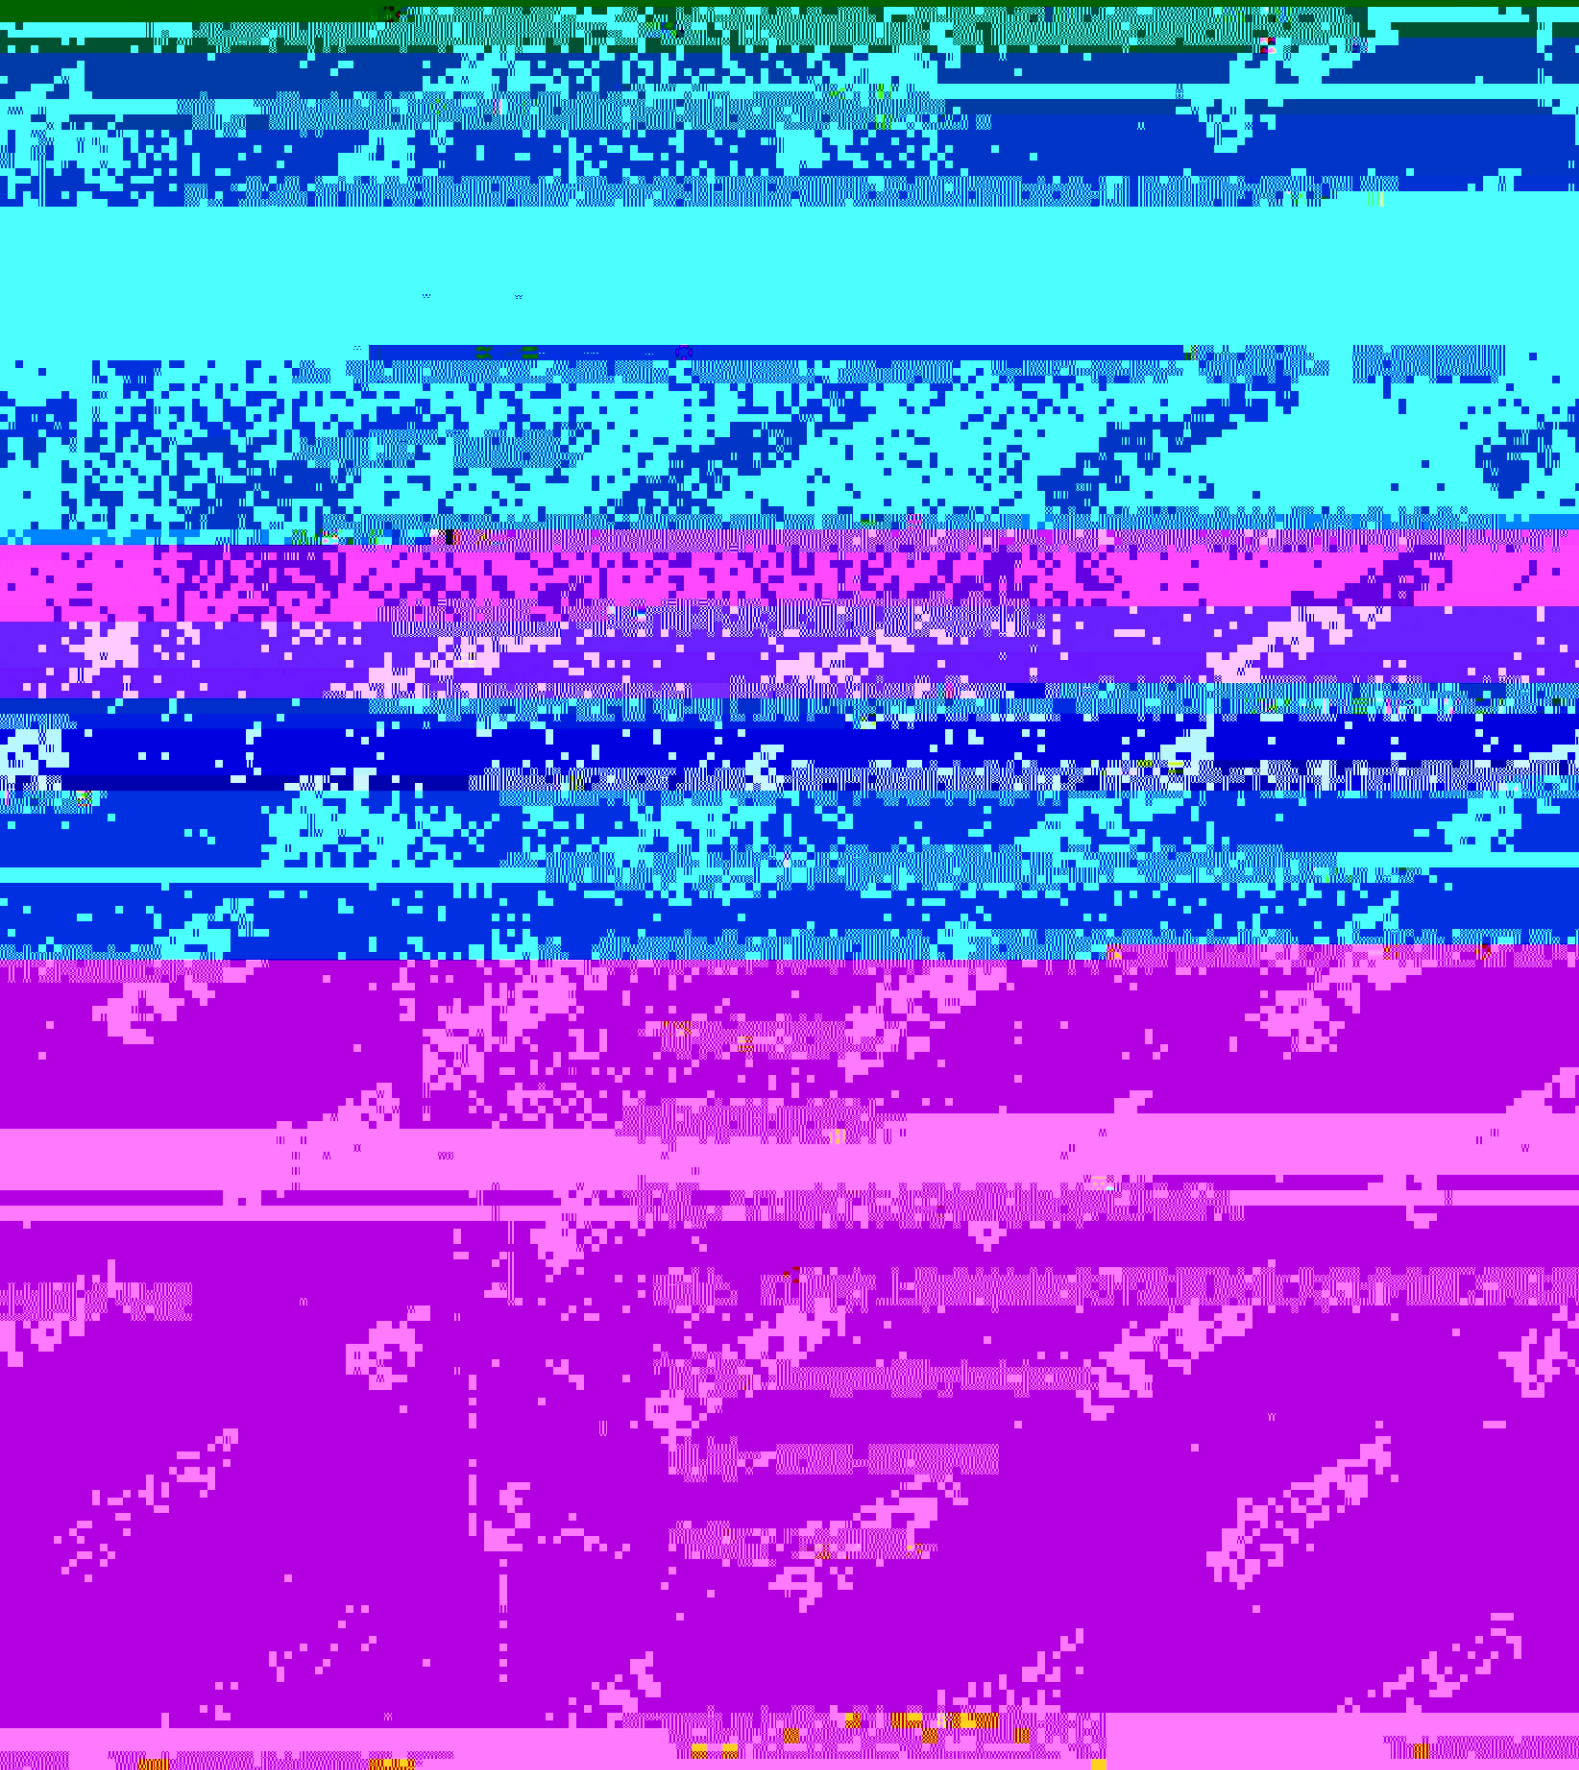

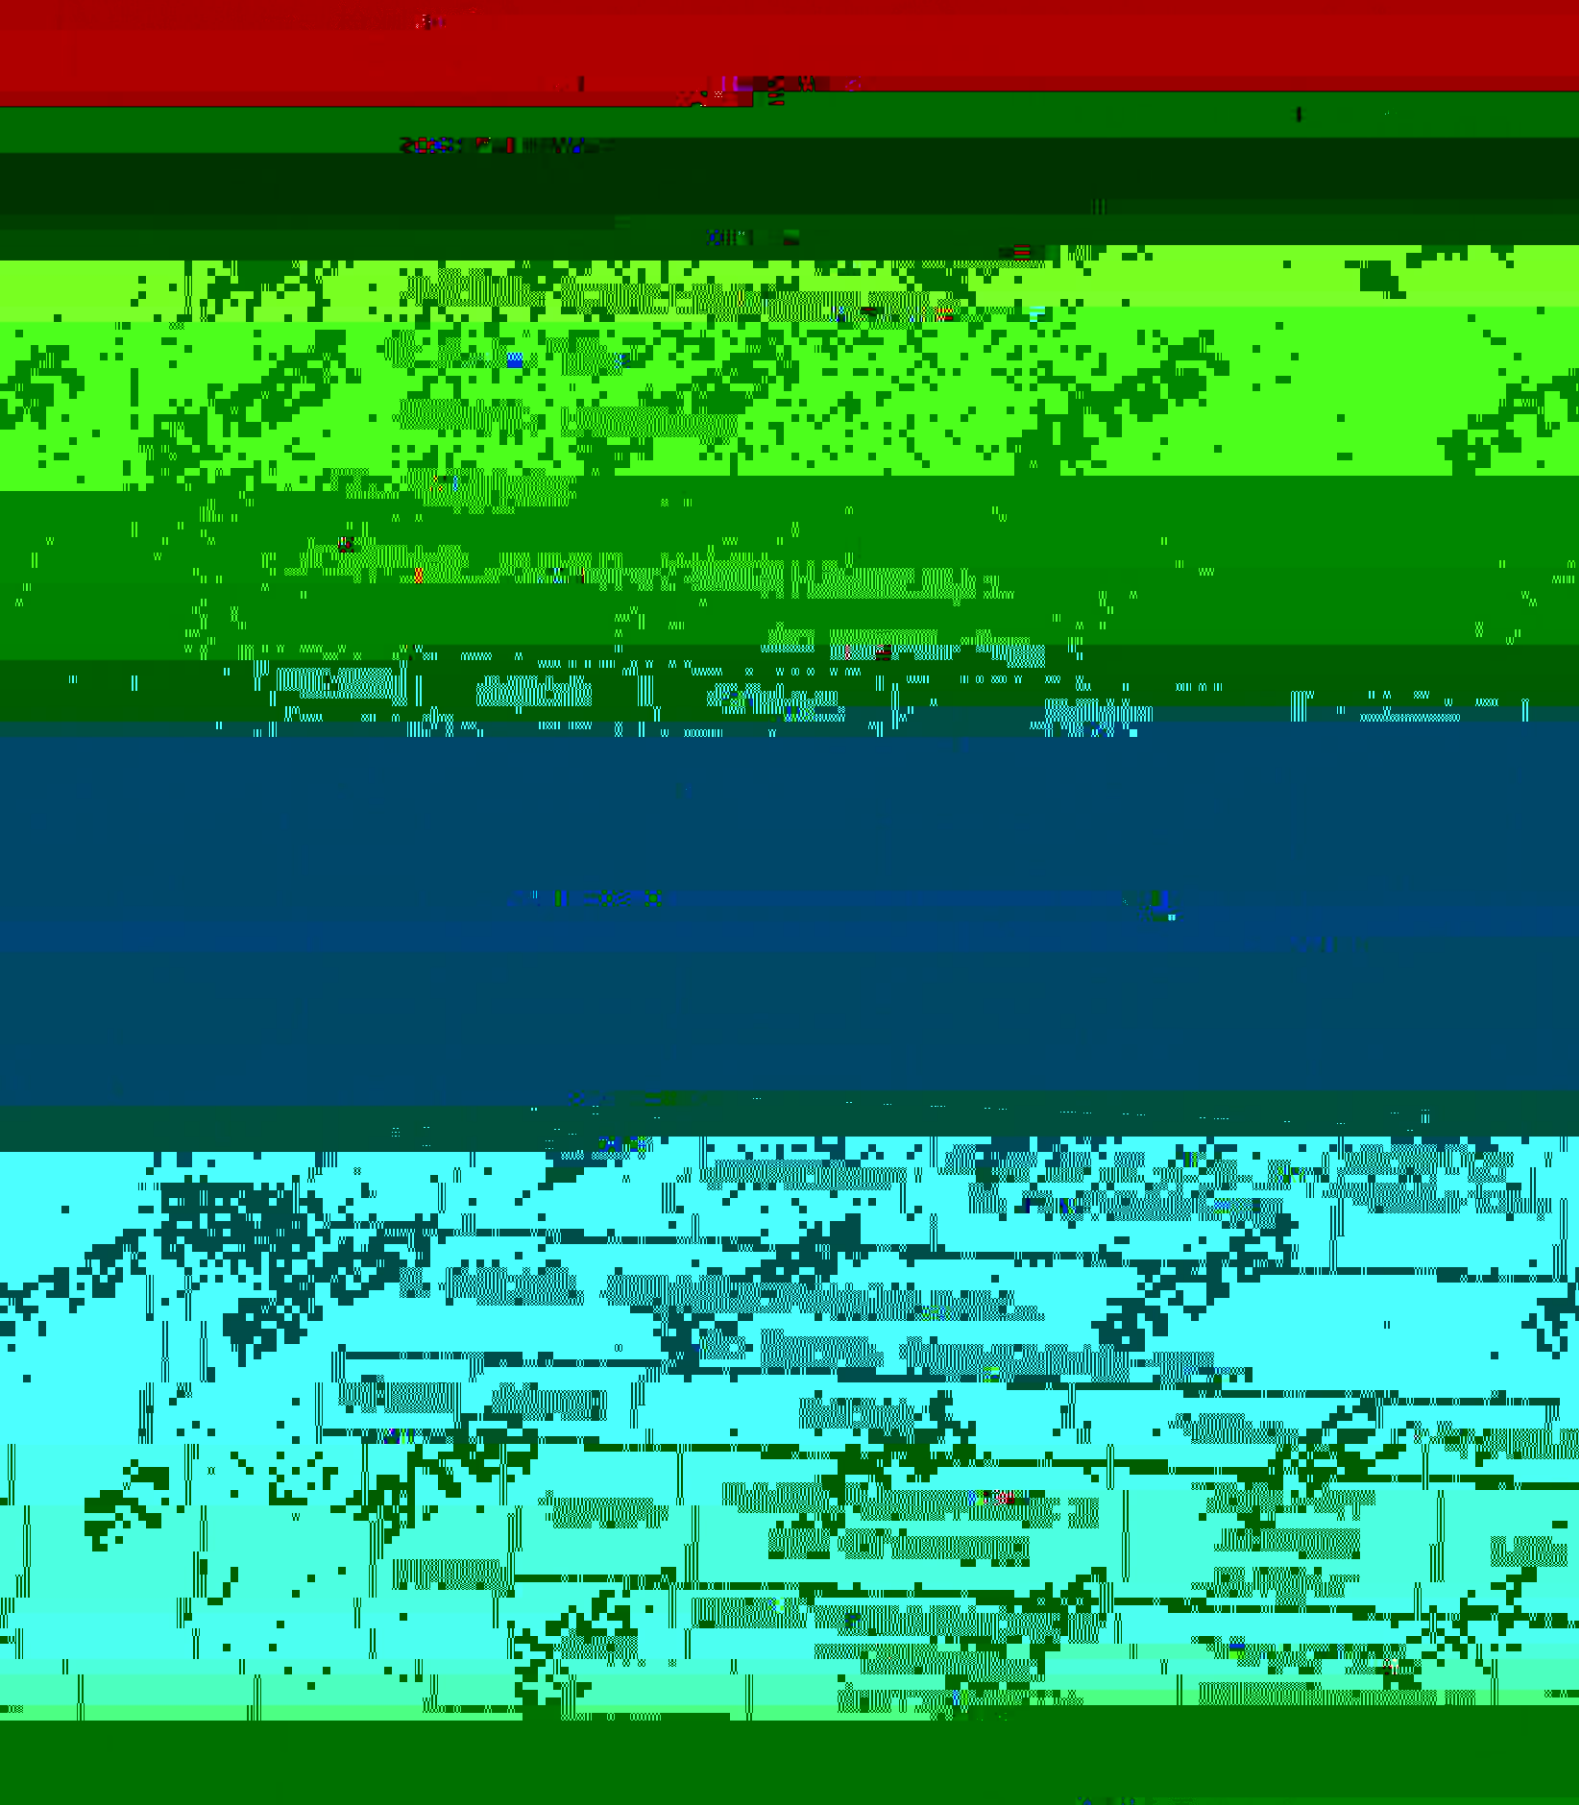

环境检测

环境检测

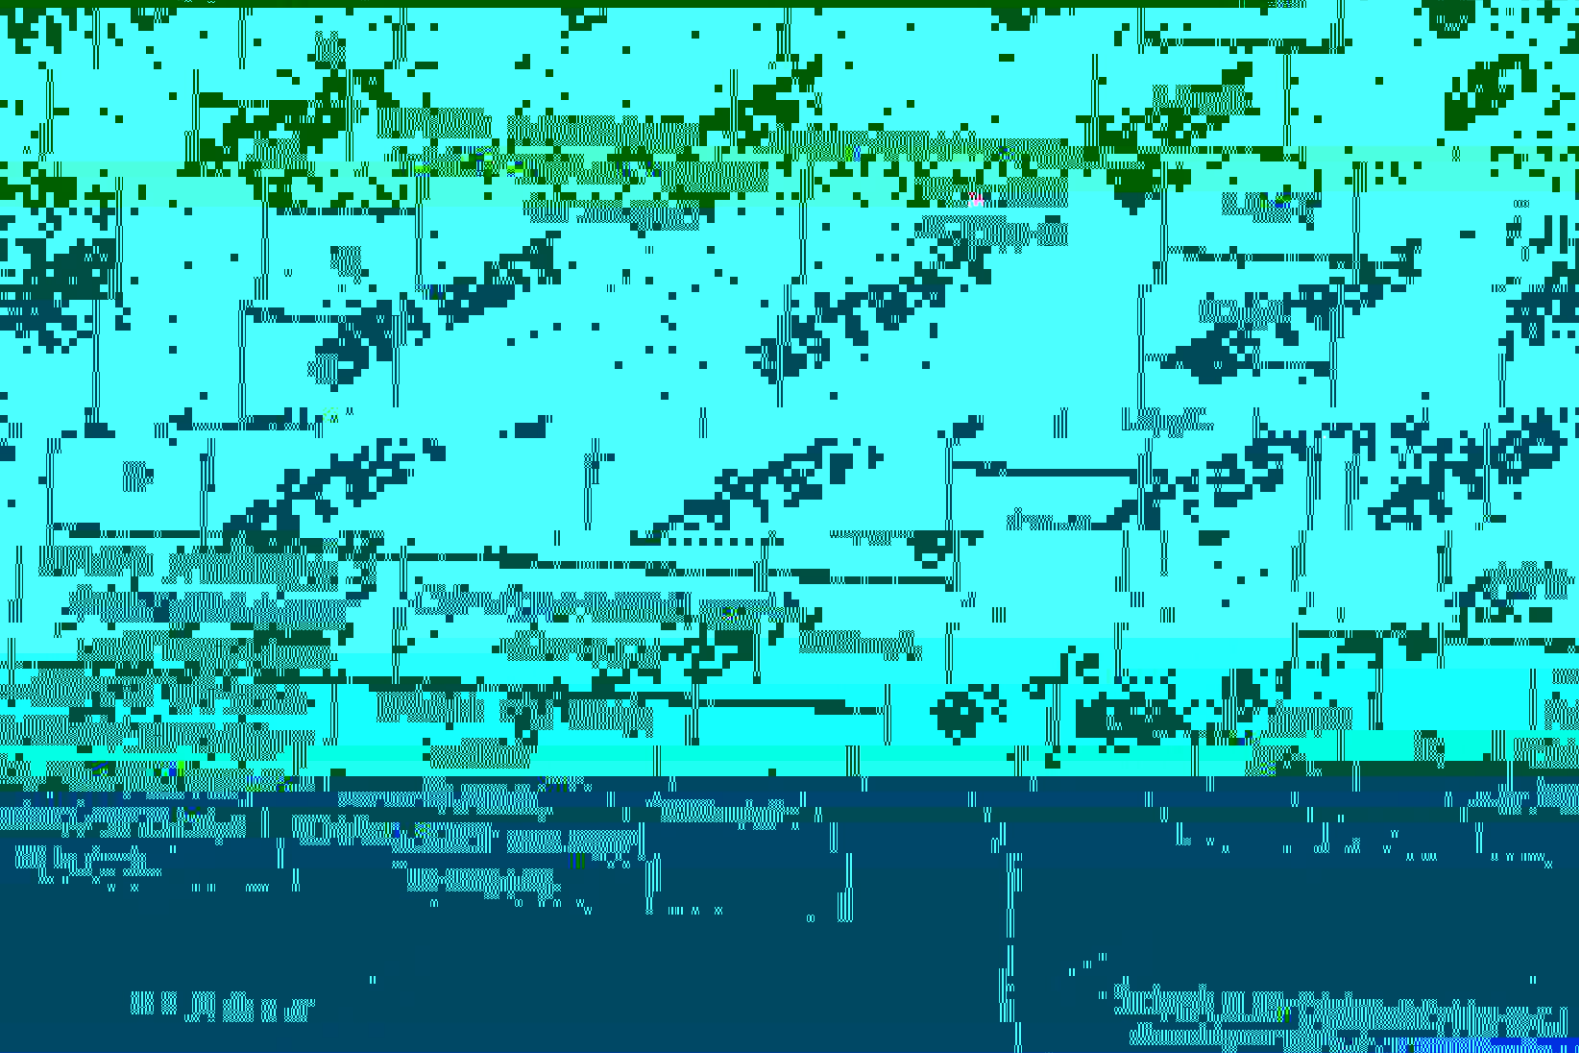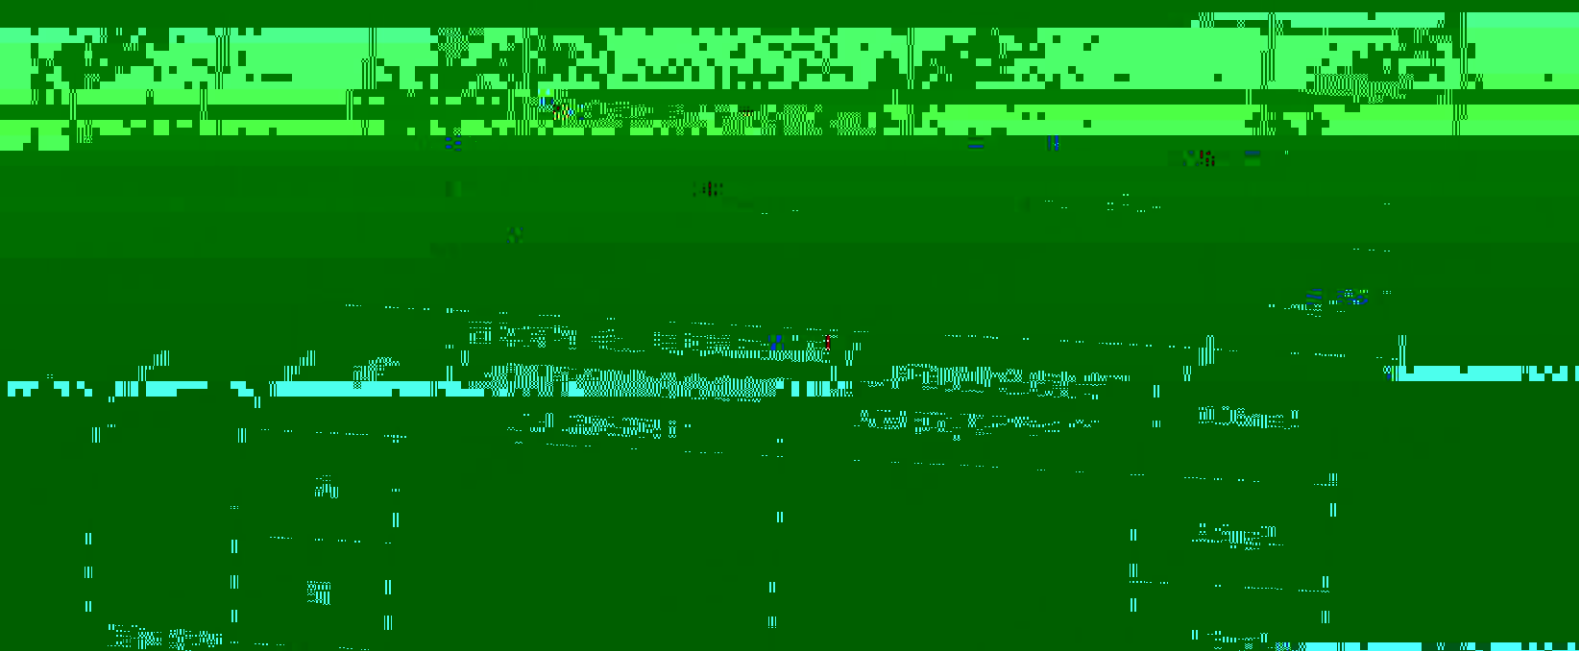

环境检测

环境检测

环境检测

续表 2 检测方法、使用仪器

序号	检测项目	检测方法	使用仪器
1	总磷	钼钼蓝法	分光光度计
2	氨氮	纳氏试剂比色法	分光光度计
3	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	分光光度计
4	溶解氧	碘量法	溶解氧测定仪
5	化学需氧量	重铬酸钾法	COD测定仪
6	生化需氧量	五日培养法	生化需氧量测定仪
7	pH值	玻璃电极法	pH计
8	电导率	电导率法	电导率仪
9	总硬度	EDTA滴定法	滴定管
10	钙硬度	EDTA滴定法	滴定管
11	镁硬度	EDTA滴定法	滴定管
12	氯离子	汞盐滴定法	滴定管
13	硫酸根	钡盐沉淀法	滴定管
14	氟离子	离子色谱法	离子色谱仪
15	硝酸盐氮	镉还原-分光光度法	分光光度计
16	亚硝酸盐氮	重氮化-分光光度法	分光光度计
17	总磷	钼钼蓝法	分光光度计
18	氨氮	纳氏试剂比色法	分光光度计
19	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	分光光度计
20	溶解氧	碘量法	溶解氧测定仪
21	化学需氧量	重铬酸钾法	COD测定仪
22	生化需氧量	五日培养法	生化需氧量测定仪
23	pH值	玻璃电极法	pH计
24	电导率	电导率法	电导率仪
25	总硬度	EDTA滴定法	滴定管
26	钙硬度	EDTA滴定法	滴定管
27	镁硬度	EDTA滴定法	滴定管
28	氯离子	汞盐滴定法	滴定管
29	硫酸根	钡盐沉淀法	滴定管
30	氟离子	离子色谱法	离子色谱仪
31	硝酸盐氮	镉还原-分光光度法	分光光度计
32	亚硝酸盐氮	重氮化-分光光度法	分光光度计
33	总磷	钼钼蓝法	分光光度计
34	氨氮	纳氏试剂比色法	分光光度计
35	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	分光光度计
36	溶解氧	碘量法	溶解氧测定仪
37	化学需氧量	重铬酸钾法	COD测定仪
38	生化需氧量	五日培养法	生化需氧量测定仪
39	pH值	玻璃电极法	pH计
40	电导率	电导率法	电导率仪
41	总硬度	EDTA滴定法	滴定管
42	钙硬度	EDTA滴定法	滴定管
43	镁硬度	EDTA滴定法	滴定管
44	氯离子	汞盐滴定法	滴定管
45	硫酸根	钡盐沉淀法	滴定管
46	氟离子	离子色谱法	离子色谱仪
47	硝酸盐氮	镉还原-分光光度法	分光光度计
48	亚硝酸盐氮	重氮化-分光光度法	分光光度计
49	总磷	钼钼蓝法	分光光度计
50	氨氮	纳氏试剂比色法	分光光度计
51	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	分光光度计
52	溶解氧	碘量法	溶解氧测定仪
53	化学需氧量	重铬酸钾法	COD测定仪
54	生化需氧量	五日培养法	生化需氧量测定仪
55	pH值	玻璃电极法	pH计
56	电导率	电导率法	电导率仪
57	总硬度	EDTA滴定法	滴定管
58	钙硬度	EDTA滴定法	滴定管
59	镁硬度	EDTA滴定法	滴定管
60	氯离子	汞盐滴定法	滴定管
61	硫酸根	钡盐沉淀法	滴定管
62	氟离子	离子色谱法	离子色谱仪
63	硝酸盐氮	镉还原-分光光度法	分光光度计
64	亚硝酸盐氮	重氮化-分光光度法	分光光度计
65	总磷	钼钼蓝法	分光光度计
66	氨氮	纳氏试剂比色法	分光光度计
67	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	分光光度计
68	溶解氧	碘量法	溶解氧测定仪
69	化学需氧量	重铬酸钾法	COD测定仪
70	生化需氧量	五日培养法	生化需氧量测定仪
71	pH值	玻璃电极法	pH计
72	电导率	电导率法	电导率仪
73	总硬度	EDTA滴定法	滴定管
74	钙硬度	EDTA滴定法	滴定管
75	镁硬度	EDTA滴定法	滴定管
76	氯离子	汞盐滴定法	滴定管
77	硫酸根	钡盐沉淀法	滴定管
78	氟离子	离子色谱法	离子色谱仪
79	硝酸盐氮	镉还原-分光光度法	分光光度计
80	亚硝酸盐氮	重氮化-分光光度法	分光光度计
81	总磷	钼钼蓝法	分光光度计
82	氨氮	纳氏试剂比色法	分光光度计
83	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	分光光度计
84	溶解氧	碘量法	溶解氧测定仪
85	化学需氧量	重铬酸钾法	COD测定仪
86	生化需氧量	五日培养法	生化需氧量测定仪
87	pH值	玻璃电极法	pH计
88	电导率	电导率法	电导率仪
89	总硬度	EDTA滴定法	滴定管
90	钙硬度	EDTA滴定法	滴定管
91	镁硬度	EDTA滴定法	滴定管
92	氯离子	汞盐滴定法	滴定管
93	硫酸根	钡盐沉淀法	滴定管
94	氟离子	离子色谱法	离子色谱仪
95	硝酸盐氮	镉还原-分光光度法	分光光度计
96	亚硝酸盐氮	重氮化-分光光度法	分光光度计
97	总磷	钼钼蓝法	分光光度计
98	氨氮	纳氏试剂比色法	分光光度计
99	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	分光光度计
100	溶解氧	碘量法	溶解氧测定仪

六、餘測

采样点编号		采样时间		2023.11.07	
采样地点		样品性状		均为灰色、臭。	
采样点及编号		炉渣		飞灰	

[illegible]

