



201712050263



湖北捷捷检测有限公司

湖北捷捷检测有限公司

湖北捷捷

湖北捷捷检测有限公司
湖北捷捷检测有限公司

湖北捷捷检测有限公司

委托检测

湖北捷捷

委托检测

委托检测

湖北捷捷检测有限公司

湖北捷捷检测有限公司

检测报告

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The *Agrobacterium* strains were grown in the YEA medium for 24 h and then adjusted to the OD₆₀₀ of 0.1. The *Agrobacterium* strains were then grown in the YEA medium with the concentration of 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 12.0, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 13.0, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14.0, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 15.0, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 16.0, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 17.0, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 18.0, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 19.0, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 20.0, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 21.0, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 23.0, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 24.0, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 25.0, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 26.0, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 27.0, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 28.0, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 29.0, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 30.0, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 31.0, 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 32.0, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 33.0, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 34.0, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9, 35.0, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 36.0, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 36.9, 37.0, 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 38.0, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9, 39.0, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 40.0, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 41.0, 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.8, 41.9, 42.0, 42.1, 42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.9, 43.0, 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9, 44.0, 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 45.0, 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.9, 46.0, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 47.0, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 48.0, 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5, 48.6, 48.7, 48.8, 48.9, 49.0, 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 49.5, 49.6, 49.7, 49.8, 49.9, 50.0, 50.1, 50.2, 50.3, 50.4, 50.5, 50.6, 50.7, 50.8, 50.9, 51.0, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8, 51.9, 52.0, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9, 53.0, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6, 53.7, 53.8, 53.9, 54.0, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5, 54.6, 54.7, 54.8, 54.9, 55.0, 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 55.5, 55.6, 55.7, 55.8, 55.9, 56.0, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.6, 56.7, 56.8, 56.9, 57.0, 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 57.5, 57.6, 57.7, 57.8, 57.9, 58.0, 58.1, 58.2, 58.3, 58.4, 58.5, 58.6, 58.7, 58.8, 58.9, 59.0, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 59.6, 59.7, 59.8, 59.9, 60.0, 60.1, 60.2, 60.3, 60.4, 60.5, 60.6, 60.7, 60.8, 60.9, 61.0, 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 61.5, 61.6, 61.7, 61.8, 61.9, 62.0, 62.1, 62.2, 62.3, 62.4, 62.5, 62.6, 62.7, 62.8, 62.9, 63.0, 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 63.7, 63.8, 63.9, 64.0, 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, 64.5, 64.6, 64.7, 64.8, 64.9, 65.0, 65.1, 65.2, 65.3, 65.4, 65.5, 65.6, 65.7, 65.8, 65.9, 66.0, 66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 66.5, 66.6, 66.7, 66.8, 66.9, 67.0, 67.1, 67.2, 67.3, 67.4, 67.5, 67.6, 67.7, 67.8, 67.9, 68.0, 68.1



招生编号：闽校报字[2025]X383号

检测报告

波調、本平曲、尺八曲 1、中品調、尺八曲 2、尺八曲、位三調、尺八曲 1、五音調、
中品調、尺八曲 2

Abstract


      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      	      
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of α -methylstyrene in the presence of SnCl_4 at 25°C .

Age Group	Percentage
18-24	~12%
25-34	~38%
35-44	~32%
45-54	~28%
55-64	~22%
65-74	~18%
75-84	~10%
85+	~5%

名称	单位	数量	单价	金额	备注
1. 材料费					
2. 人工费					
3. 机械费					
4. 管理费					
5. 利润					
6. 税金					
7. 合计					

[illegible]



迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2023]X365号

五日生化需氧量

mg/L

8.0

7.7

8.7

8.1

20

合格

检测项目	检测日期	检测地点	检测人员	检测仪器	检测结果	检测单位	检测备注
五日生化需氧量	2023-05-10	XX市XX区XX路XX号	张三	YS-1000	8.5	迅捷检测	符合标准
五日生化需氧量	2023-05-11	XX市XX区XX路XX号	李四	YS-1000	8.2	迅捷检测	符合标准
五日生化需氧量	2023-05-12	XX市XX区XX路XX号	王五	YS-1000	8.8	迅捷检测	符合标准
五日生化需氧量	2023-05-13	XX市XX区XX路XX号	赵六	YS-1000	8.3	迅捷检测	符合标准
五日生化需氧量	2023-05-14	XX市XX区XX路XX号	孙七	YS-1000	8.6	迅捷检测	符合标准
五日生化需氧量	2023-05-15	XX市XX区XX路XX号	周八	YS-1000	8.4	迅捷检测	符合标准
五日生化需氧量	2023-05-16	XX市XX区XX路XX号	吴九	YS-1000	8.7	迅捷检测	符合标准
五日生化需氧量	2023-05-17	XX市XX区XX路XX号	郑十	YS-1000	8.1	迅捷检测	符合标准

注: 1. 本检测报告仅对委托检测的项目负责, 不对其他项目负责。2. 本检测报告仅对委托检测的样品负责, 不对其他样品负责。3. 本检测报告仅对委托检测的时间负责, 不对其他时间负责。4. 本检测报告仅对委托检测的地点负责, 不对其他地点负责。5. 本检测报告仅对委托检测的人员负责, 不对其他人员负责。6. 本检测报告仅对委托检测的仪器负责, 不对其他仪器负责。7. 本检测报告仅对委托检测的结果负责, 不对其他结果负责。8. 本检测报告仅对委托检测的单位负责, 不对其他单位负责。9. 本检测报告仅对委托检测的备注负责, 不对其他备注负责。10. 本检测报告仅对委托检测的备注负责, 不对其他备注负责。

三、质量控制

1. 本实验室严格按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求, 建立了完善的质量管理体系。

2. 本实验室严格按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求, 建立了完善的质量管理体系。

3. 本实验室严格按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求, 建立了完善的质量管理体系。

4. 本实验室严格按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求, 建立了完善的质量管理体系。

5. 本实验室严格按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求, 建立了完善的质量管理体系。

6. 本实验室严格按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求, 建立了完善的质量管理体系。

7. 本实验室严格按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求, 建立了完善的质量管理体系。

8. 本实验室严格按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求, 建立了完善的质量管理体系。

9. 本实验室严格按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求, 建立了完善的质量管理体系。

10. 本实验室严格按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求, 建立了完善的质量管理体系。

11. 本实验室严格按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求, 建立了完善的质量管理体系。

12. 本实验室严格按照《检验检测机构资质认定管理办法》的要求, 建立了完善的质量管理体系。

检测项目	检测日期	检测地点	检测人员	检测仪器	检测结果	检测单位	检测备注
五日生化需氧量	2023-05-10	XX市XX区XX路XX号	张三	YS-1000	8.5	迅捷检测	符合标准
五日生化需氧量	2023-05-11	XX市XX区XX路XX号	李四	YS-1000	8.2	迅捷检测	符合标准
五日生化需氧量	2023-05-12	XX市XX区XX路XX号	王五	YS-1000	8.8	迅捷检测	符合标准
五日生化需氧量	2023-05-13	XX市XX区XX路XX号	赵六	YS-1000	8.3	迅捷检测	符合标准
五日生化需氧量	2023-05-14	XX市XX区XX路XX号	孙七	YS-1000	8.6	迅捷检测	符合标准
五日生化需氧量	2023-05-15	XX市XX区XX路XX号	周八	YS-1000	8.4	迅捷检测	符合标准
五日生化需氧量	2023-05-16	XX市XX区XX路XX号	吴九	YS-1000	8.7	迅捷检测	符合标准
五日生化需氧量	2023-05-17	XX市XX区XX路XX号	郑十	YS-1000	8.1	迅捷检测	符合标准

迅捷检测

[illegible]



四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限

表 0 检测项目分析方法、主要仪器及检出限

表 0 检测项目分析方法、主要仪器及检出限

序号	检测项目	检测方法	主要仪器	检出限
1	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	TU-1901 型双光束紫外可见分光光度计	XJFYX005-01	0.01mg/L
2	水质 汞、砷、硒、铊和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-8220 原子荧光光度计	XJFYX012-01	0.001μg/L
3	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 700-2014	ICP-MS7800 电感耦合等离子体质谱仪	XJFYX011-01	0.001μg/L
4	水质 石油类和动植物油类 红外分光光度法 HJ 637-2012	DM600 型红外光测油仪	XJFYX013-01	0.06mg/L



迅捷检测

报告编号: 迅捷检字(2018)000000号

图 1

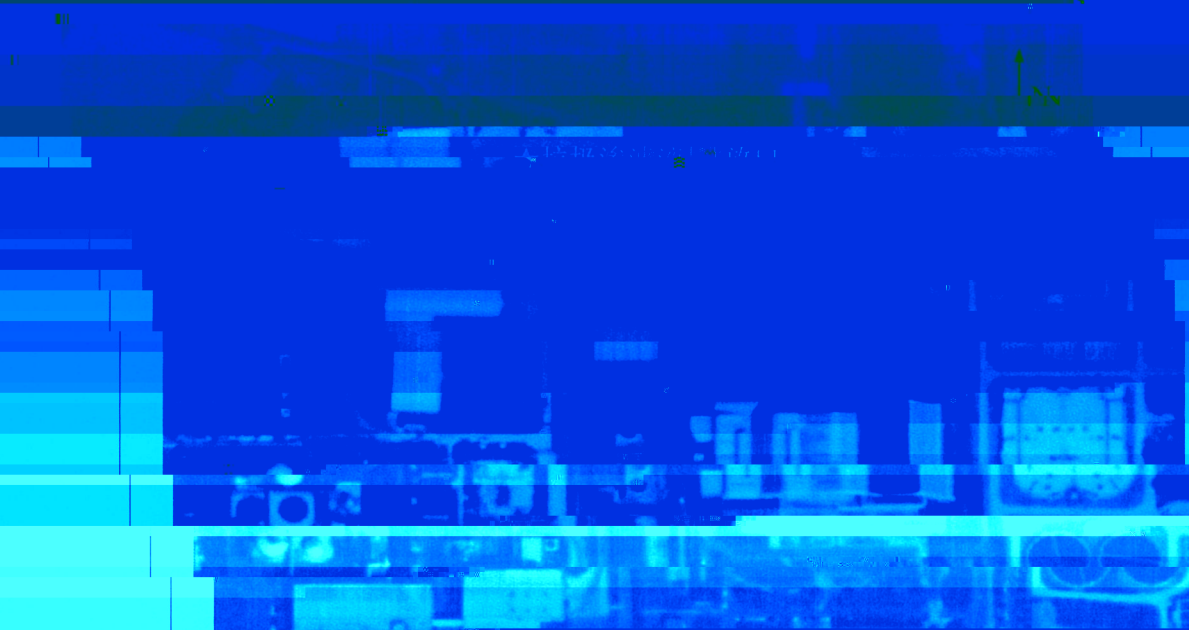


图 1 混凝土试件在试验机上的加载情况

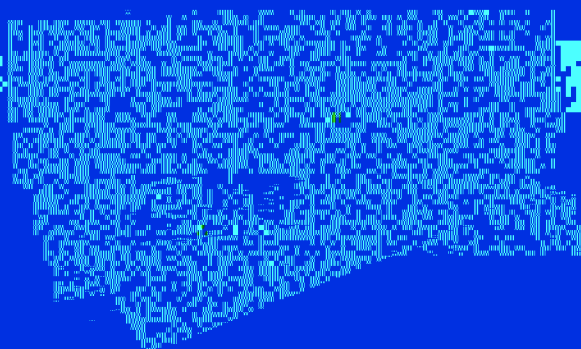


图 2 混凝土试件破坏形态

图 3 混凝土试件

图 4 混凝土试件

图 5 混凝土试件

图 6 混凝土试件

